



КВЕРТИ-МЕД

Анализатор АГКМ-01К



Руководство по эксплуатации

Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	3
3. СОСТАВ ПРИБОРА.....	4
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	5
4.1. Устройство прибора.....	5
4.2. Принцип работы.....	7
5. ПОРЯДОК МОНТАЖА И УСТАНОВКИ.....	8
5.1. Удаление транспортных фиксаторов.....	8
5.2. Установка (замена) сенсора.....	8
5.3. Подготовка Системного гемолизирующего реагента.....	9
5.4. Подготовка Калибратора.....	10
5.5. Принтер.....	11
5.6. Подключение к компьютеру.....	12
6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	13
6.1. Включение-выключение прибора.....	13
6.2. Управление прибором.....	14
6.3. Режим «ПРОБА».....	16
6.4. Режим «НАЛИВ».....	19
6.5. Режим «СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ».....	20
6.6. Режим «УСТАНОВКИ».....	22
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА.....	23
8. ПЕРЕЧЕНЬ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАКАЗА.....	23
9. МАРКИРОВКА.....	23
10. УПАКОВКА.....	24
11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	24
12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	24

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Анализатор АГКМ-01К (в дальнейшем - прибор) предназначен для измерения концентрации глюкозы и лактата в цельной крови, сыворотке и плазме.

Прибор применяется в клинико-диагностических лабораториях учреждений здравоохранения.

По устойчивости к воздействиям климатических факторов прибор относится к изделиям категории 4.2 исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.

По устойчивости к механическим воздействиям прибор относится к изделиям группы 2 по ГОСТ Р 50444.

По способу защиты оператора от поражения электрическим током прибор относится к классу 1 тип Н по ГОСТ 12.2.025.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диапазон измерений концентрации:

- глюкоза..... 1.00 - 30.0 ммоль/л;
- лактат..... 1.00 - 15.0 ммоль/л.

2.2. Относительная погрешность прибора - $\pm 5\%$.

2.3. Длительность одного цикла измерений 40 сек.

2.4. Поворотный круг на 40 позиций, включая служебные.

2.5. Объем пробы 20 мкл.

2.6. Энергонезависимая память для результатов последних 8000 измерений.

2.7. Время готовности прибора к работе после включения не более 20 мин.

2.8. Габаритные размеры прибора не более 400x320x500 мм.

2.9. Масса прибора без упаковки не более 14 кг.

2.10. Мощность, потребляемая прибором, не более 80 В*А.

3. СОСТАВ ПРИБОРА

В комплект прибора входят:

- Блок анализатора АГКМ-01К..... 1шт.

Комплект сменных и запасных частей

- Уплотнительное резиновое кольцо поршневого насоса (СЧ.ЭГК.0005)..... 1 шт.

Техническая документация

- Паспорт..... 1экз.
- Руководство по эксплуатации..... 1экз.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство прибора



Рисунок 1 – Вид спереди

Вид прибора спереди показан на рисунке 1. Управление прибором производится при помощи 6-ти кнопок на панели управления. Отображение результатов и режимов работы производится на индикаторе. Результаты измерений распечатываются на принтере. Сенсор находится в сенсорном боксе. Пробы, Калибратор и Контроль качества в микропробирках устанавливаются в поворотный круг. Поворотный круг имеет 34 позиции для проб, 1 позицию для экстренной пробы (позиция «Э»), 2 позиции для Калибратора (позиции «К1» и «К2»), 1 позицию для Контроля качества (позиция «КК»), 1 позицию «НАЧАЛО КРУГА» (между позициями «К2» и №1) и 1 позицию «ПРОМЫВКА» (между позициями №19 и №20).

ВНИМАНИЕ!!! Позиция «ПРОМЫВКА» предназначена для периодической промывки трубок прибора. В ней **всегда** должна находиться **микропробирка без крышки** (с отрезанной крышкой). Эта микропробирка не нуждается в замене, кроме случаев длительного простоя прибора в выключенном состоянии.

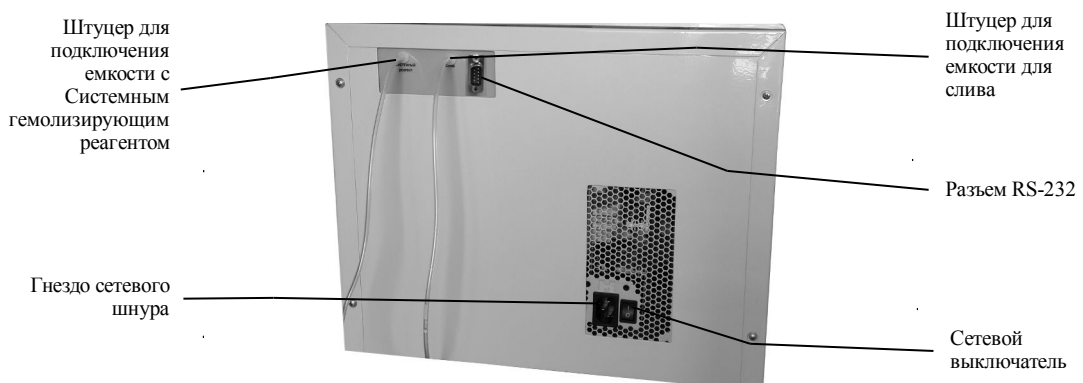


Рисунок 2 – Вид сзади

На задней панели прибора (см. рисунок 2) находятся штуцеры для подключения емкостей с Системным гемолизирующим реагентом и для слива, а также разъем RS-232, сетевой

выключатель и гнездо сетевого шнура. Емкость с Системным гемолизирующим реагентом (5 л), а также емкость для слива (5 л) находятся ниже уровня прибора (на полу).

На рисунке 3 показана гидравлическая схема прибора. Схема соответствует виду сзади со снятым кожухом.

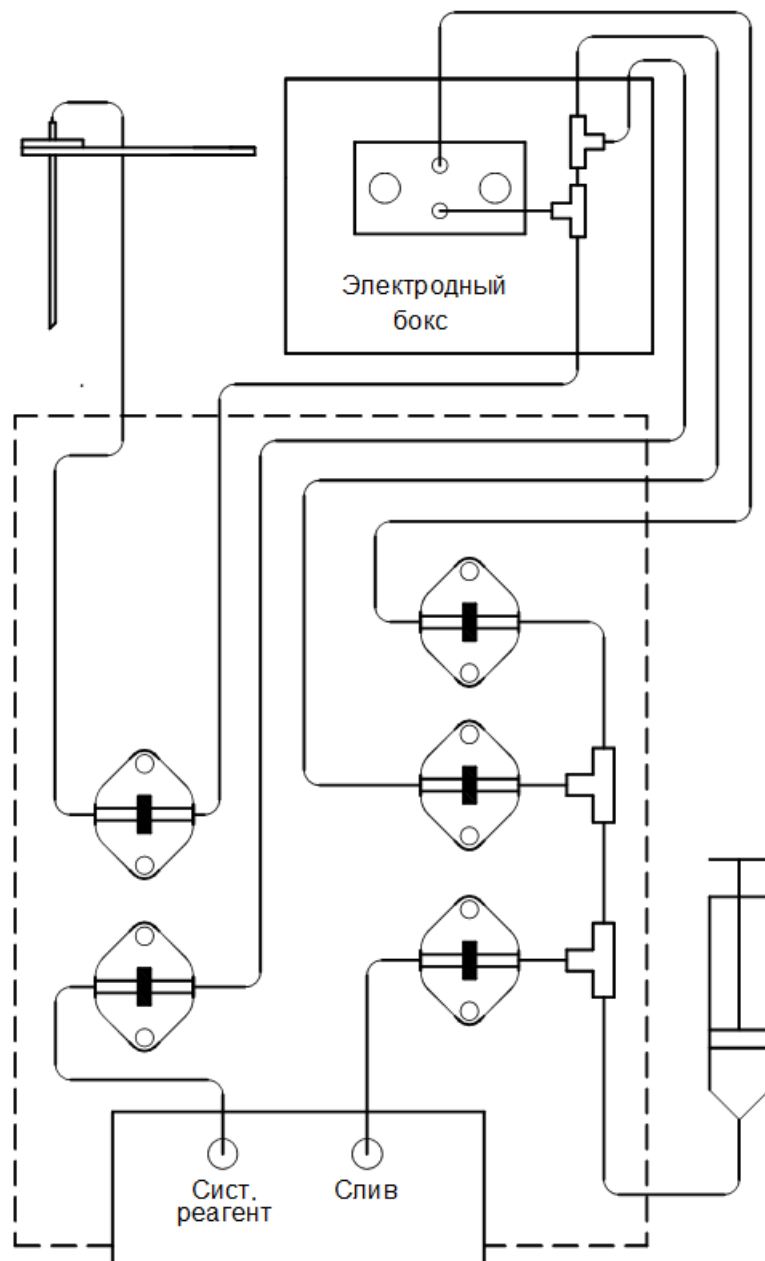


Рисунок 3 – Гидравлическая схема прибора

4.2. Принцип работы

Сенсор с глюкозооксидазной (лактатоксидазной) мембраной описывается формулой:

$$G = (dI/dt)_{\max} \cdot k,$$

где G – концентрация глюкозы (лактата) в анализируемом растворе, ммоль/л; I – ток, создаваемый сенсором, пА; $(dI/dt)_{\max}$ – максимальное значение скорости изменения тока, пА/с; k – чувствительность сенсора, ммоль*с/л*пА.

Для Калибратора:

$$G_{\text{конт}} = (dI_{\text{конт}}/dt)_{\max} \cdot k \text{ или } k = G_{\text{конт}} / (dI_{\text{конт}}/dt)_{\max},$$

где $G_{\text{конт}}$ – концентрация глюкозы (лактата) в Калибраторе, ммоль/л; $I_{\text{конт}}$ – ток, создаваемый сенсором в Калибраторе, пА.

Таким образом, измеряя $(dI_{\text{конт}}/dt)_{\max}$, прибор вычисляет величину k .

Для пробы имеем:

$$G_{\text{пр}} = (dI_{\text{пр}}/dt)_{\max} \cdot k,$$

где $G_{\text{пр}}$ – концентрация глюкозы (лактата) в пробе, ммоль/л; $I_{\text{пр}}$ – ток, создаваемый сенсором в пробе, пА.

Таким образом, измеряя максимальное значение скорости изменения тока сенсора в пробе, прибор вычисляет концентрацию глюкозы (лактата) в пробе.

5. ПОРЯДОК МОНТАЖА И УСТАНОВКИ

5.1. Удаление транспортных фиксаторов

На время транспортировки мотор привода прибора фиксируется двумя пластиковыми стяжками, которые расположены рядом с принтером. Перед началом работы стяжки необходимо удалить, аккуратно срезав их.

5.2. Установка (замена) сенсора

Установка (замена) сенсора производится только тогда, когда прибор выключен.

ВНИМАНИЕ!!! Не спешите менять сенсор. Текущее состояние сенсора характеризует параметр Чувствительность (см. п. 6.5.1.1). Однако, чувствительность может быть низкой из-за того, что при калибровке использовался некачественный Калибратор или Системный гемолизирующий реагент. Поэтому для исключения ошибки, перед тем как менять сенсор необходимо операцию калибровки повторить несколько раз со свежим Калибратором и Системным гемолизирующим реагентом до воспроизводимости результатов.

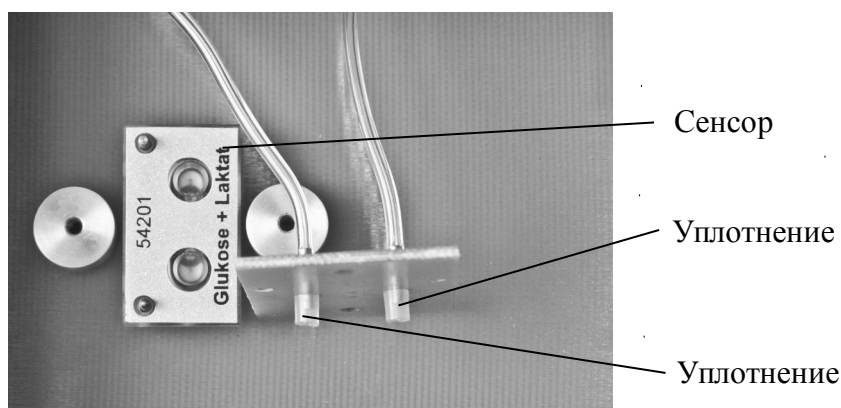


Рисунок 4 – Сенсорный бокс с поднятой фиксирующей планкой

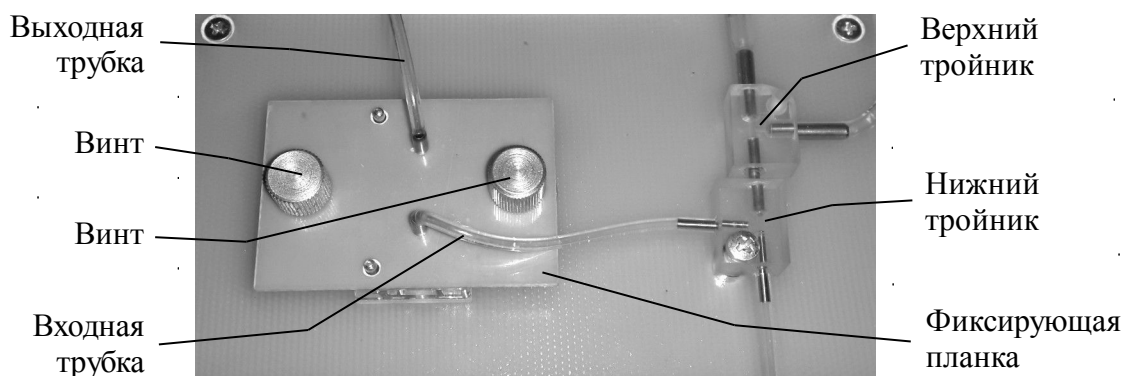


Рисунок 5 – Сенсорный бокс

Установка сенсора выполняется следующим образом.

- Установить сенсор на направляющие штифты так, как показано на рисунке 4.
- Наложить на сенсор фиксирующую планку так, как показано на рисунке 5.
- Завинтить оба винта.

Удаляется сенсор в обратной последовательности.

При наложении на сенсор фиксирующей планки необходимо обратить внимание на то, что уплотнения (см. рисунок 4) находятся на месте, а также на то, что два направляющих штифта вошли в соответствующие отверстия на фиксирующей планке.

ВНИМАНИЕ!!! *Вновь установленный сенсор может быть нестабилен в течение нескольких часов. Поэтому после установки нового сенсора включите прибор, но не приступайте к работе в течение 4-х часов.*

В приборе могут использоваться сенсоры 3-х видов:

- сенсор «3000», средний ресурс 4000 проб и 3 месяца работы (арт. СЧ.Г00.0002);
- сенсор «10000», средний ресурс 12000 проб и 4 месяца работы (арт. СЧ.Г00.0003);
- сенсор «30000», средний ресурс 30000 проб и 9 месяцев работы (арт. СЧ.Г00.0004).

Выбор конкретного сенсора осуществляется с учетом ежедневной нагрузки лаборатории. Неиспользуемые сенсоры должны храниться в холодильнике при температуре +2 - +8 °С.

5.3. Подготовка Системного гемолизирующего реагента

Концентрат системного гемолизирующего реагента (арт. РМ.Г00.0019, 1 л/флакон) предназначен для приготовления 5 л Системного гемолизирующего реагента. Системный гемолизирующий реагент готовится путем добавления к 1 литру концентрата 4-х литров дистиллированной воды. После добавления дистиллированной воды реагент следует тщательно перемешать и дать отстояться в течение 2-х часов.

Когда в рабочей емкости прибора закончится Системный гемолизирующий реагент прибор выдаст сообщение «Опорожни Слив. ПУСК-Подтверждение!». В этот момент следует опорожнить емкость для слива и после этого нажать кнопку ПУСК. Затем прибор выдаст сообщение «Залей Системный реагент. ПУСК-Залив». В этот момент следует залить в рабочую емкость прибора 5 литров Системного гемолизирующего реагента и после этого нажать кнопку ПУСК. Необходимо помнить, что перед заливом Системного гемолизирующего реагента в рабочую емкость необходимо освободить ее от остатков реагента и ополоснуть дистиллированной водой.

ВНИМАНИЕ!!! *Рабочая емкость с Системным гемолизирующим реагентом и емкость для слива должны располагаться ниже уровня прибора, желательно на полу под столом, на котором располагается прибор.*

5.4. Подготовка Калибратора

Калибратор глюкозы 10,0 ммоль/л и лактата 4,0 ммоль/л (арт. РМ.Г00.0005) и Калибратор глюкозы 10,0 ммоль/л (арт. РМ.Г00.0007) поставляются во флаконах 5 мл.

Калибратор приготавливается для измерения точно так же, как и Пробы (см. п. 6.3.1). Для этого 20 мкл Калибратора добавляется в микропробирку с Системным гемолизирующим реагентом и тщательно перемешивается. Системный гемолизирующий реагент наливается в микропробирку в режиме «НАЛИВ» (см. п. 6.4). Приготовленный таким образом Калибратор в закрытой микропробирке стабилен по глюкозе не менее 14 дней, по лактату — не менее 7 дней.

Если при эксплуатации прибора не используется режим «НАЛИВ» (см. п. 6.4), а Системный гемолизирующий реагент наливается в микропробирки при помощи внешнего дозатора 1 мл, то нужно делать приготовление Калибратора следующим образом. Необходимо приготовить 51 мл путем добавления 1 мл Калибратора к 50 мл Системного гемолизирующего реагента, а затем разлить по микропробиркам не менее 1,3 мл в каждую. При таком способе работы необходимо помнить следующее:

- приготовленный таким способом Калибратор глюкозы должен быть израсходован в течение 14 дней, а Калибратор глюкозы и лактата — в течение 7 дней;
- для постановки в поворотный круг в микропробирку необходимо наливать не менее 1,3 мл Калибратора, в противном случае его не хватит на 4 цикла измерения.

ВНИМАНИЕ!!! Для работы с прибором можно использовать только такие микропробирки, крышки которых предназначены для прокалывания иглой. Такая крышка имеет по центру тонкий слой полиэтилена (0,1 — 0,2 мм) диаметром примерно 6 мм. Микропробирки с другими крышками прибор проколоть не сможет.

5.5. Принтер

Принтер с заряженным рулоном бумаги и открытой крышкой показан на рисунке 6.

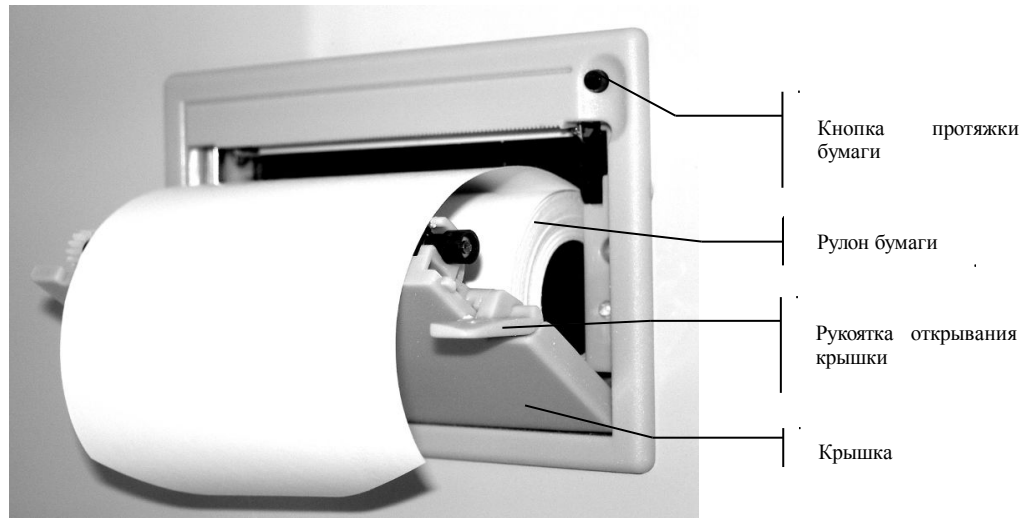


Рисунок 6 – Принтер

Бумага в принтер заряжается в следующей последовательности:

- открыть крышку принтера потянув на себя рукоятку открывания крышки;
- вложить в принтер рулон бумаги так, как показано на рисунке 6;
- закрыть крышку принтера;
- задвинуть рукоятку открывания крышки «заподлицо»;
- проверить протяжку бумаги нажав кнопку протяжки бумаги.

5.6. Подключение к компьютеру

Прибор может быть подключен к компьютеру с использованием интерфейса RS-232.

ВНИМАНИЕ!!! Очень важно, чтобы прибор и компьютер были включены в сеть 220 В так, чтобы их контакты заземления были замкнуты. В противном случае возможен выход из строя микросхем интерфейса в приборе или в компьютере. Простейший вариант правильного включения – включить прибор и компьютер в один и тот же сетевой удлинитель, имеющий клемму заземления, а удлинитель в свою очередь включить в сеть 220 В.

Для подключения к компьютеру необходимо использовать 9-ти контактный нуль – модемный (предназначенный для соединения 2-х компьютеров) кабель интерфейса RS-232. Разъем для подключения кабеля находится на задней панели прибора рядом со штуцерами для подключения растворов.

Используемый режим интерфейса RS-232 следующий: асинхронный нормальный, скорость 9600 бод, без контроля четности, 8 бит данных, 1 стоп-бит. Кодировка символов ASCII.

Прибор передает в компьютер результаты в следующем формате: Час (2 позиции) / минута (2 позиции) / день (2 позиции) / месяц (2 позиции) / номер лунки (1 или 2 позиции) / G1 / результат (требуемое количество позиций) / Lt / результат (требуемое количество позиций) / ... и т.д. для всех лунок. Например, распечатке результатов измерения, приведенной на рисунке 7, соответствует следующая последовательность символов, переданных по интерфейсу RS-232: 17/21/16/07/15/G1/12.51/Lt/5.14/32/G1/4.36/Lt/1.80/.

```

AGKM-01K
17:21 16/07/2014
NN G1 Lt
15 ↑ 12.51 ↑ 5.14
32 4.36 1.80
<=== Calibration OK ===>
< Sens Time Imp >
<G1 15.1 49 1.0 >
<Lt 23.6 55 1.0 >
< NN G1 Lt >
< Nu1 0.03 0.00 >
< KK 27.68 10.52 >
<==== Calibration =====>

```

Рисунок 7 – Распечатка результатов

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Включение-выключение прибора

- 6.1.1. Прибор должен быть всегда включен. Постоянное нахождение прибора во включенном состоянии обеспечивает стабильное состояние сенсора и, соответственно, его постоянную готовность к измерениям. Если прибор включается с новым сенсором или после длительного нахождения в выключенном состоянии, то перед началом измерений рекомендуется выждать сутки, чтобы дать время сенсору перейти в стабильное состояние.

***ВНИМАНИЕ !!!** В результате кратковременного пропадания напряжения в сети прибор может выключиться. При этом сетевой тумблер остается в положении «включено». В этом случае необходимо выключить сетевой тумблер, выждать минимум 5 минут, а затем снова включить сетевой тумблер.*

- 6.1.2. Выключение прибора на длительный срок с целью вывода из эксплуатации производится в следующей последовательности:

- выключить прибор кнопкой Вкл./Выкл., расположенной на панели управления;
- выключить сетевой тумблер на задней панели прибора и вынуть сетевой шнур из розетки.

После хранения в таком состоянии при новом включении скорее всего потребуются замена сенсора.

- 6.1.3. Включение прибора после вывода из эксплуатации по п. 6.1.2 или после установки нового сенсора производится в следующей последовательности:

- подключить емкость с Системным гемолизирующим реагентом и емкость для слива к штуцерам на задней панели прибора;
- включить сетевой тумблер на задней панели прибора;
- оставить прибор на сутки для стабилизации сенсора.

После включения наступает время подготовки и прогрева прибора (не более 15 минут). При этом на индикатор выдается сообщение «АГКМ-01К. ПОДГОТОВКА». Если на прогревом приборе произошел перезапуск программы в результате кратковременного пропадания электропитания, то этап прогрева пропускается.

6.2. Управление прибором

В приборе имеются режимы 3-х уровней. К режимам 1-го уровня относятся: «ПРОБА», «НАЛИВ», «СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ» и «УСТАНОВКИ». Дерево режимов изображено на рисунке 9, где шрифтом и размером рамки показаны уровни режимов.

В общем случае перебор режимов в пределах одного уровня осуществляется кнопкой *РЕЖИМ*, переход на режим следующего уровня осуществляется кнопкой *ПУСК*, а возврат на предыдущий уровень – кнопкой *СТОП*. Если режима следующего уровня не существует, то нажатие кнопки *ПУСК* вызывает запуск программы текущего режима на исполнение.

Например, чтобы запустить на исполнение режим «Залив. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ», необходимо выполнить действия, показанные на рисунке 8.

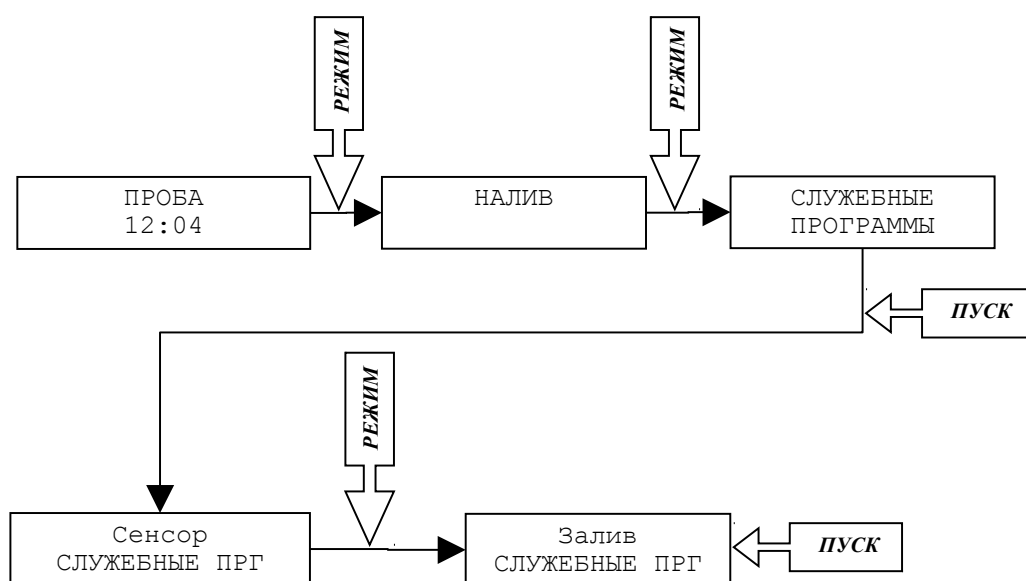


Рисунок 8 – Запуск на исполнение режима «Залив. СЛУЖЕБНЫЕ ПРГ»

Кнопки *БОЛЬШЕ* и *МЕНЬШЕ* служат для изменения (когда необходимо) численных значений величин, а также для просмотра результатов последних 8000 измерений на индикаторе (только когда на индикаторе сообщение «ПРОБА»).

Если оператор не нажимает кнопки, то прибор автоматически возвращается к режиму «ПРОБА», проходя в обратном порядке ранее выбранные режимы и останавливаясь на каждом на 10 секунд.

Когда прибор подает звуковой сигнал, он тем самым привлекает внимание оператора к сообщению, выводимому на индикатор. Такие сообщения могут быть напоминаниями, могут сигнализировать об окончании протяженного во времени режима, могут призывать оператора выполнить какие-либо действия, например, «Сделать калибровку?», и т. д. В любом случае при подаче прибором звукового сигнала оператор должен прочесть сопутствующее сообщение на индикаторе и предпринять адекватные действия.

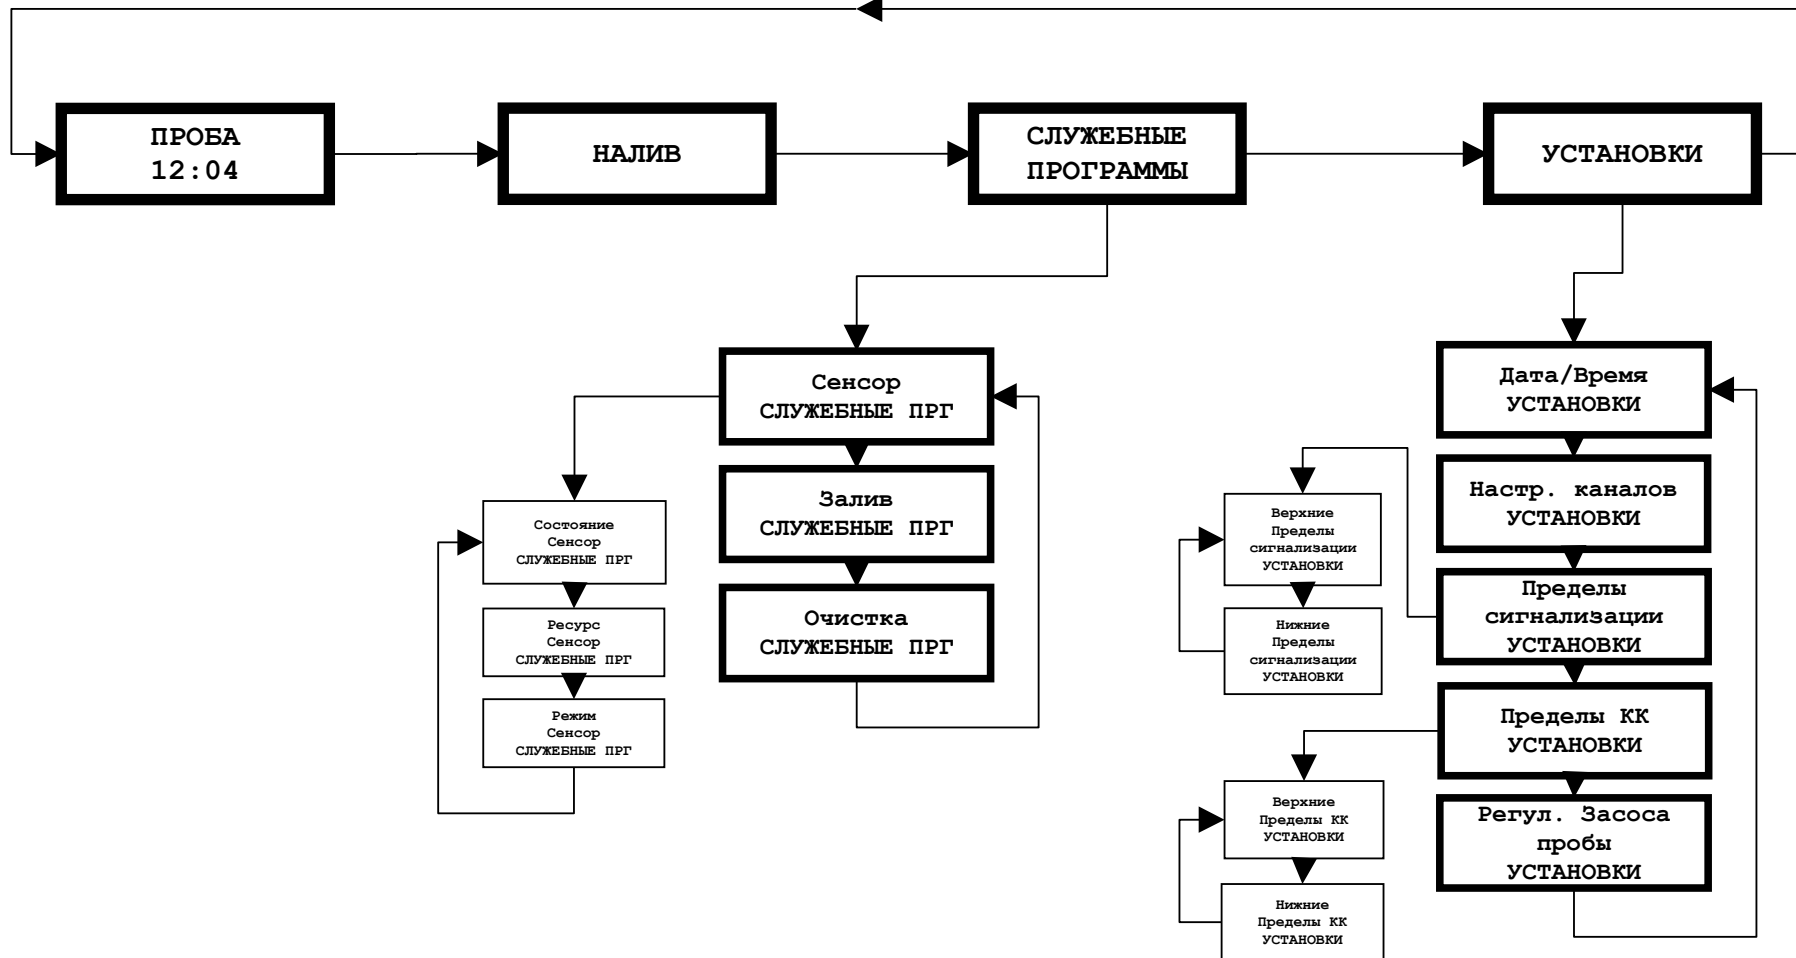


Рисунок 9 — Дерево режимов

6.3. Режим «ПРОБА»

6.3.1. Подготовка Проб, Калибратора и Контроля качества

Проба приготавливается путем добавления 20 мкл крови, сыворотки или плазмы в микропробирку с Системным гемолизирующим реагентом. Системный гемолизирующий реагент наливается в микропробирки в режиме «НАЛИВ» (см. п. 6.4).

Также возможна такая организация работы прибора, когда для налива Системного гемолизирующего реагента в микропробирки используется внешний дозатор 1 мл. В этом случае Калибратор должен приготавливаться соответствующим образом (см. п. 5.4).

Проба может дозироваться пипеточным дозатором 20 мкл или «end-to-end» капилляром 20 мкл. В случае использования «end-to-end» капилляра (рекомендуется использовать гепаринизированные «end-to-end» капилляры) последний просто помещается в микропробирку. После этого микропробирку необходимо закрыть и тщательно перемешать содержимое многократным (20 — 30 раз) переворачиванием микропробирки.

ВНИМАНИЕ!!! Плохо перемешанная проба может быть источником ошибки.

Приготовленная таким образом проба в закрытой микропробирке стабильна в течение 12 часов.

ВНИМАНИЕ!!! Для работы с прибором можно использовать только такие микропробирки, крышки которых предназначены для прокалывания иглой. Такая крышка имеет по центру тонкий слой полиэтилена (0,1 — 0,2 мм) диаметром примерно 6 мм. Микропробирки с другими крышками прибор проколоть не сможет.

Необходимо помнить, что операция дозирования 20 мкл пробы имеет погрешность, которая напрямую переходит в погрешность результатов измерений. Поэтому для улучшения воспроизводимости и точности результатов измерений необходимо придерживаться рекомендаций по воспроизводимому и точному дозированию объемов.

Например, при работе с пипеточным дозатором важно использовать один и тот же дозатор для приготовления Проб и Калибратора. Внесение пробы в микропробирку дозатором необходимо делать всегда однотипно, - или с ополаскиванием наконечника, или без ополаскивания. И так далее, полный перечень рекомендаций смотрите в руководстве используемого дозатора.

Подготовка Калибратора (см. п. 5.4) делается точно так же, как подготовка пробы.

Подготовка Контроля качества делается точно так же, как подготовка пробы.

6.3.2. Установка Проб, Калибратора и Контроля качества в поворотный круг

Пробы устанавливаются в любые позиции от №1 до №34, а также в позицию «Э» (экстренная проба).

Калибратор устанавливается в позиции «К1» и/или «К2». Прибор делает 4 цикла измерения из каждой микропробирки с Калибратором, поэтому в них должно быть достаточное количество Калибратора (не менее 1,3 мл). В случае использования режима «НАЛИВ» (см.

п. 6.4) это обеспечивается прибором. В случае использования внешнего дозатора 1 мл об этом должен позаботиться оператор (см. п. 5.4). При использовании двух микропробирок с Калибратором обеспечивается повышенная точность измерений по сравнению с использованием одной микропробирки с Калибратором. Рекомендуется устанавливать две микропробирки с Калибратором если устанавливается больше 10 Проб.

Контроль качества устанавливается в позицию «КК».

6.3.3. Процесс измерений

Процесс измерений начинается после нажатия на кнопку ПУСК когда на индикаторе сообщение «ПРОБА». Он начинается с процедуры калибровки с последующей проверкой. Если эта процедура (калибровка с проверкой) закончится успешно, то начинаются измерения Проб. В противном случае измерения Проб не производятся.

Если предыдущая калибровка была по времени не более 1 часа назад, то прибор выдаст запрос: «Сделать калибровку?». На него можно ответить «ДА» (кнопка ПУСК) или «НЕТ» (кнопка СТОП). Если не предпринять никаких действий в течение 10 секунд, то это будет равносильно ответу «ДА». Для повышения точности измерений рекомендуется всегда делать калибровку. Ее можно отменить в случае необходимости срочно измерить небольшое количество Проб, возможно не очень точно.

6.3.3.1. Калибровка с проверкой

Процедура калибровки с проверкой состоит из собственно калибровки и последующей проверки. Проверка заключается в измерении Холостой пробы (не содержащей глюкозы и лактата), которая находится в позиции «ПРОМЫВКА», и Контроля качества. Результаты этих измерений подвергаются допусковому контролю, по результатам которого калибровка признается успешной или начинается заново. Если микропробирка с Контролем качества не установлена, то контроль по ней не производится. Процедура заканчивается если калибровка признается успешной или если заканчивается Калибратор.

Границы допускового контроля Холостой пробы установлены жестко. Границы допускового контроля для Контроля качества устанавливаются пользователем в режиме «Пределы КК. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ» (см. п. 6.6.4). Предустановленные с завода значения предполагают использование в качестве Контроля качества тройной дозы Калибратора (60 мкл вместо 20 мкл), чему соответствует результат измерения 28,8 ммоль/л по глюкозе и 11,5 ммоль/л по лактату.

Отчет о калибровке выдается вместе с распечаткой результатов (см. рисунок 7). Он содержит данные о чувствительности (Sens), отсчете времени (Time) и длительности импульса (Imp) в обоих каналах. Также он содержит результаты измерения Холостой пробы (Nul) и Контроля качества (КК).

Если во время калибровки возникли ошибки в канале измерения глюкозы и/или лактата, то после калибровки прибор вместо текущего времени будет выдавать сообщение «Ошибка Гл», или «Ошибка Лт», или «Ошибка Гл и Лт».

В случае возникновения ошибки, вначале необходимо убедиться в том, что используются правильные Калибратор и Системный гемолизирующий реагент, и что реагент не закончился.

Затем необходимо посмотреть величину чувствительности сенсора (см. п. 6.5.1.1). Если притом, что с Калибратором и Системным гемолизирующим реагентом все в порядке, а чувствительность сенсора по результатам калибровки стабильно получается около 1,00 (что и приводит к сообщению «Ошибка»), то канал с ошибкой нужно выключить (см. п. 6.5.1.3). Если не выключить канал с ошибкой, то это сделает невозможной работу исправного канала.

Если оба канала содержат ошибки (сообщение «Ошибка Гл и Лт»), то использовать данный сенсор невозможно.

6.3.3.2. Измерение Проб

Если калибровка с проверкой прошла успешно, то начинается собственно измерение Проб. Этот процесс начинается и заканчивается измерением Калибраторов оставшихся после процесса калибровки. Это делается для повышения точности измерений, в результате Калибраторы в процессе измерения Проб расходуются полностью.

В момент измерения Пробы на индикатор выдается предварительный результат измерения, который будет скорректирован позднее по результатам измерения Калибратора после измерения Проб. Окончательный результат измерения Проб выдается в распечатке на принтере.

Микропробирки с пробами можно добавлять в поворотный круг даже если измерения уже начались. Для измерения экстренной пробы нужно поставить ее в позицию «Э» и нажать кнопку *ПУСК*. После этого на индикаторе возникнет подтверждающее сообщение «Экстренная проба будет измерена». Затем (не сразу, но как можно раньше) экстренная проба будет измерена и результат будет распечатан на принтере.

Для прекращения процесса измерений необходимо нажать кнопку *СТОП*. После этого на индикаторе возникнет подтверждающее сообщение «Измерения будут прерваны». Затем измерения Проб будут прекращены, но завершающие измерения Калибратора будут выполнены.

На распечатке результатов измерения Проб рядом со значением результата могут быть распечатаны символы «↑» или «↓», которые сигнализируют, что результат вышел за допустимые пределы. Величина этих пределов настраивается в режиме «Пределы сигнализации. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ» (см. п. 6.6.3).

Если с момента последней очистки прошло больше чем 6 месяцев, то после распечатки результатов измерения Проб прибор напечатает напоминание «Пора сделать очистку» (см. п. 6.5.3).

Результаты измерений хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Они сгруппированы так, как и были измерены, т.е. по загрузкам в поворотный круг Их можно посмотреть на индикаторе нажимая кнопки *БОЛЬШЕ* и/или *МЕНЬШЕ* когда на индикаторе сообщение «ПРОБА», при этом на индикатор выдаются результаты из разных загрузок. Для идентификации загрузки сверху указаны время и дата, когда она была измерена. Когда результат на индикаторе, то нажимая кнопку *РЕЖИМ* можно просматривать результаты Проб в различных позициях данной загрузки, а если нажать кнопку *ПУСК*, то результаты данной загрузки будут распечатаны на принтере.

6.4. Режим «НАЛИВ»

Режим «НАЛИВ» предназначен для налива Системного гемолизирующего реагента в микропробирки. Для налива пустые микропробирки устанавливаются в свободные позиции поворотного круга, после чего запускается на исполнение режим «НАЛИВ».

ВНИМАНИЕ!!! Открытые крышки микропробирок должны быть ориентированы в центр поворотного круга, в противном случае они будут задевать за детали механизма.

Если в поворотном круге находятся полные (непустые) микропробирки, то в них налив делаться не будет.

ВНИМАНИЕ!!! Микропробирки под налив должны быть сухими и чистыми, а в идеале — новыми из упаковки. В мокрую микропробирку (со следами Системного гемолизирующего реагента на стенках) прибор делать налив не будет.

Количество Системного гемолизирующего реагента, наливаемого в микропробирки, локально стабильно, но зависит от разницы уровней прибора и реагента в рабочей емкости. Оно оптимизировано для такого варианта, когда прибор располагается на столе, а рабочая емкость, — на полу под столом. Поэтому во время налива нельзя перемещать рабочую емкость с Системным гемолизирующим реагентом. Также не рекомендуется делать налив очень большого числа микропробирок, так как в процессе такого налива уровень жидкости в рабочей емкости изменится существенно.

Рекомендуется делать одномоментно налив не более 300 микропробирок. Вначале они должны быть израсходованы полностью для приготовления Проб, Калибраторов и Контролей качества, а затем уже делается налив следующей партии и т. д.

ВНИМАНИЕ!!! Для работы с прибором можно использовать только такие микропробирки, крышки которых предназначены для прокалывания иглой. Такая крышка имеет по центру тонкий слой полиэтилена (0,1 — 0,2 мм) диаметром примерно 6 мм. Микропробирки с другими крышками прибор проколоть не сможет.

6.5. Режим «СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Режим «СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ» содержит режимы «Сенсор», «Залив» и «Очистка».

6.5.1. Режим «Сенсор. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Содержит режимы «Состояние», «Ресурс» и «Режим».

6.5.1.1. Режим «Состояние. Сенсор. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ»

При каждой калибровке прибор определяет чувствительность сенсора (отдельно по глюкозе и лактату) и момент наступления максимума тока сенсора. Значения этих параметров (Чув. и Отс.) можно просмотреть в данном режиме после калибровки. Переключение между глюкозой и лактатом осуществляется нажатием кнопки *РЕЖИМ*. Также эти параметры распечатываются на принтере в отчете о калибровке.

В норме чувствительность должна быть больше 1,00. Если чувствительность около 1,00, то прибор после калибровки выдает сообщение «Ошибка Гл», или «Ошибка Лт», или «Ошибка Гл и Лт» (см. п. 6.3.3.1).

В норме параметр Отсчет должен быть от 35 до 135.

6.5.1.2. Режим «Ресурс. Сенсор. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ»

В этом режиме можно посмотреть количество суток, прошедших с момента установки сенсора, а также количество проб, которые он отработал.

6.5.1.3. Режим «Режим. Сенсор. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ»

В данном режиме можно выбрать один из 3-х возможных вариантов работы сенсора: «Только глюкоза», «Только лактат» и «Глюкоза и лактат». Перебор вариантов осуществляется нажатием кнопки *РЕЖИМ*, выход - нажатием кнопки *СТОП*.

6.5.2. Режим «Залив. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ»

В этом режиме заполняется трубка подачи Системного гемолизирующего реагента от емкости с этим реагентом до рабочего положения. Он используется, например, при первоначальном заполнении трубки во время запуска прибора в эксплуатацию.

6.5.3. Режим «Очистка. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Очистка прибора должна делаться не реже 1 раза в 6 месяцев. Очистка прибора делается перед установкой нового сенсора (на старом сенсоре!!!), при этом старый сенсор окончательно теряет чувствительность.

Очистка производится в следующей последовательности.

Прибор	Оператор
ПРОБА	Нажимает кнопку <i>РЕЖИМ</i>
НАЛИВ	Нажимает кнопку <i>РЕЖИМ</i>
СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ	Нажимает кнопку <i>ПУСК</i>
Сенсор. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ	Нажимает кнопку <i>РЕЖИМ</i>
Залив. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ	Нажимает кнопку <i>РЕЖИМ</i>
Очистка. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ	Нажимает кнопку <i>ПУСК</i>
Сенсор погибнет!!! Уверен?	Нажимает кнопку <i>ПУСК</i> (или <i>СТОП</i> , если не уверен)
Подключи Удалитель загрязнений и нажми <i>ПУСК</i>	Вынимает трубку из емкости с Системным реагентом и опускает ее в емкость с Удалителем загрязнений, после чего нажимает кнопку <i>ПУСК</i> . Удалителя загрязнений должно быть не меньше 50 мл
Идет очистка (30 минут)	Ждет
Отключи Удалитель загрязнений и нажми <i>ПУСК</i>	Вынимает трубку из емкости с Удалителем загрязнений (оставляет ее в воздухе), после чего нажимает кнопку <i>ПУСК</i>
Ждите	Ждет. Протирает трубку чистой тканью чтобы удалить остатки Удалителя загрязнений с внешней поверхности трубки.
Подключи Системный реагент и нажми <i>ПУСК</i>	Опускает трубку в емкость с Системным реагентом, после чего нажимает кнопку <i>ПУСК</i> . Перед опусканием в Системный реагент трубка должна быть протерта чистой тканью, чтобы удалить остатки Удалителя загрязнений
Ждите	Ждет
Отключи Системный реагент и нажми <i>ПУСК</i>	Вынимает трубку из емкости с Системным реагентом (оставляет ее в воздухе), после чего нажимает кнопку <i>ПУСК</i>
Ждите	Ждет
Замени Систем. чашку Подключи Системный реагент и нажми <i>ПУСК</i>	Заменяет микропробирку в позиции «ПРОМЫВКА» (между позициями №19 и №20) на чистую. Опускает трубку в емкость с Системным реагентом, после чего нажимает кнопку <i>ПУСК</i>
Ждите	Ждет
Готово. Убери сенсор	Убирает старый сенсор. Питание прибора в данном случае выключать не нужно
Поставь сенсор и нажми <i>ПУСК</i>	Устанавливает новый сенсор и нажимает кнопку <i>ПУСК</i>

ВНИМАНИЕ!!! Попадание Удалителя загрязнений на сенсор выводит его из строя полностью. Поэтому не забывайте заменить микропробирку в позиции «ПРОМЫВКА» на чистую, чтобы убрать возможные остатки Удалителя загрязнений. Это необходимо для того, чтобы этот раствор в будущем не попал на новый сенсор.

Одного флакона Удалителя загрязнений (арт. РМ.ЭГК.0005) (100 мл/флакон) достаточно для 2-х очисток.

Если с момента последней очистки прошло больше чем 6 месяцев, то при распечатке результатов измерений прибор будет печатать напоминание «Пора сделать очистку».

6.6. Режим «УСТАНОВКИ»

Режим «УСТАНОВКИ» содержит режимы «Дата/Время», «Настройка каналов», «Пределы сигнализации», «Пределы КК» и «Регулировка засоса Пробы».

6.6.1. Режим «Дата/Время. УСТАНОВКИ»

В этом режиме устанавливаются дата и время. Выбор устанавливаемой величины осуществляется кнопкой *РЕЖИМ*, установка значения – кнопками *БОЛЬШЕ* и *МЕНЬШЕ*, окончание режима – кнопкой *ПУСК*.

6.6.2. Режим «Настройка каналов. УСТАНОВКИ»

Этот режим предназначен для настройки показаний каналов глюкозы и лактата. Исходные (предустановленные на заводе) настройки каналов следующие: глюкоза - 100%, лактат — 100%. Если изменить настройку канала на, например, 110%, то это означает, что показания данного канала будут увеличены на 10% или, что тоже самое, умножены на число 1,1.

Выбор настраиваемого канала (отмечен звездочкой) осуществляется кнопкой *РЕЖИМ*, установка значения – кнопками *БОЛЬШЕ* и *МЕНЬШЕ*. Окончание режима – кнопка *СТОП*.

При нажатии на кнопку *ПУСК* (когда на индикаторе список настраиваемых каналов) прибор вернет значения настроек каналов к исходным (предустановленным на заводе) величинам. Для выполнения этой операции прибор запросит подтверждение.

6.6.3. Режим «Пределы сигнализации. УСТАНОВКИ»

Содержит режимы «Верхние пределы» и «Нижние пределы». Предназначен для установки верхнего и нижнего пределов показаний глюкозы и лактата, при выходе за которые возникает сигнализация в распечатке результатов измерений (см. п. 6.3.3.2). Выбор настраиваемого канала (отмечен звездочкой) осуществляется кнопкой *РЕЖИМ*, установка значения – кнопками *БОЛЬШЕ* и *МЕНЬШЕ*. Окончание режима – кнопка *СТОП*.

6.6.4. Режим «Пределы КК. УСТАНОВКИ»

Содержит режимы «Верхние пределы» и «Нижние пределы». Предназначен для установки верхнего и нижнего пределов показаний глюкозы и лактата в Контроле качества, при выходе за которые результат допускового контроля считается отрицательным (см. п. 6.3.3.1). Выбор настраиваемого канала (отмечен звездочкой) осуществляется кнопкой *РЕЖИМ*, установка значения – кнопками *БОЛЬШЕ* и *МЕНЬШЕ*. Окончание режима – кнопка *СТОП*.

6.6.5. Режим «Регулировка засоса Пробы. УСТАНОВКИ»

При всасывании Пробы в прибор ее «голова» должна остановиться в электродном боксе в строго определенной позиции. Имеется в виду та позиция, до которой всасывается Проба перед тем, как начинается ее протягивание через сенсор. Эта позиция находится на 10 — 20 мм выше верхнего тройника (см. рисунок 5). Если «голова» Пробы проходит дальше (выше) упомянутой позиции, то величину засоса Пробы нужно уменьшить, а если «голова» не доходит до нее, - увеличить.

Установка требуемого значения осуществляется кнопками *БОЛЬШЕ* и *МЕНЬШЕ*. Окончание режима – кнопка *СТОП*.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Работы по обслуживанию прибора проводятся по мере возникновения необходимости, однако существует рекомендуемая периодичность таких работ, которая приведена ниже.

Периодичность	Содержание работы по обслуживанию прибора	Пункт Руководства
По напоминанию прибора	Заполнение емкости с Системным гемолизирующим реагентом Опустошение емкости для слива	5.3
По сообщению прибора об ошибках и по фактически отработанному ресурсу	Замена сенсора	5.2
Не реже 1 раза в 6 месяцев, перед заменой сенсора	Очистка прибора	6.5.3

8. ПЕРЕЧЕНЬ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Наименование	Примечание	Пункт Руководства
СЧ.Г00.0002	Сенсор «3000»		5.2
СЧ.Г00.0003	Сенсор «10000»		5.2
СЧ.Г00.0004	Сенсор «30000»		5.2
РМ.Г00.0019	Концентрат системного гемолизирующего реагента	1 л/флакон	5.3
РМ.Г00.0005	Калибратор глюкозы 10,0 ммоль/л и лактата 4,0 ммоль/л	5 мл/флакон	5.4
РМ.Г00.0007	Калибратор глюкозы 10,0 ммоль/л	5 мл/флакон	5.4
РМ.ЭГК.0005	Удалитель загрязнений	100 мл/флакон	6.5.3

9. МАРКИРОВКА

На каждом приборе должны быть нанесены товарный знак предприятия-изготовителя, наименование и обозначение типа прибора, заводской номер и год выпуска.

На ящике из гофрированного картона должна быть этикетка с надписями: наименование и обозначение типа прибора, товарный знак предприятия-изготовителя, дата упаковки. На ящике должны быть основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать», «Боится сырости» по ГОСТ 14192.

10. УПАКОВКА

Прибор должен быть упакован согласно комплекту укладок в полиэтиленовый чехол и ящик из гофрированного картона. Прибор и коробка для запасных частей в ящике из гофрированного картона должны быть закреплены с помощью амортизирующих прокладок.

Упаковка прибора, запасных частей, технической документации должна обеспечивать сохранность их товарного вида.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование приборов осуществляется железнодорожным, морским, автомобильным и авиационным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

В случае транспортирования самолетом приборы должны размещаться в отапливаемых отсеках. Транспортирование приборов морским транспортом должно производиться в специальной упаковке с применением герметичных полиэтиленовых мешков ГОСТ 10354, в которые помещают силикагель ГОСТ 3956.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня поступления к потребителю.

Гарантия не распространяется на сменные части и расходные материалы. Гарантия не распространяется на текущее обслуживание прибора.

Гарантийный ремонт осуществляется при условии транспортирования прибора в оригинальной упаковке на предприятие-изготовитель или в авторизованный сервисный центр.

Адрес предприятия-изготовителя: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30, ООО «НПП КВЕРТИМЕД».

Телефон: (347) 293-7494, 274-2830.

E-mail: service@kwertymed.ru, kwertymed@mail.ru.

Web-страница: <http://www.kwertymed.ru>